

25.652.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.652.1402 (694-1302)
Tanımı	3x40 m ³ /h (Tank=500 litre), Medikal hava merkezi
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	94200,00	1460,00	730,00
2022-1	278756,00	2756,25	1378,13
2013	135789,00	1197,00	598,50
2020	124200,00	3370,00	1685,00
2014	144000,00	1320,00	660,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	1098643,58	11812,33	5906,17
2022-2	400448,00	2756,25	1378,13
2022-3	401274,00	3583,13	1791,57
2023-1	514672,50	5547,50	2773,75
2018	81090,00	2260,00	1130,00
2023-2	721743,75	8968,75	4484,38
2017	80800,00	1970,00	985,00
2021	158800,00	4120,00	2060,00
2016	80660,00	1830,00	915,00
2019	92340,00	2860,00	1430,00

25.652.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

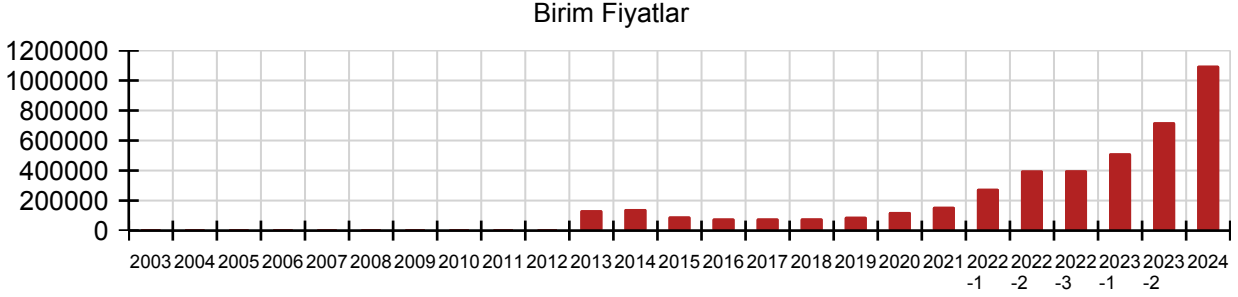

Yapım Şartları

Medikal Hava Merkezi (Ölçü: Tk)

Üçlü kompresör grubu, otomatik kontrol paneli, hava deposu, kurutucu, filtre grubu ve basınç regülatörleri ile komple, kontrol paneli yeterli basınç depo edilinceye kadar kompresörleri sırayla veya gerektiği kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen. TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, Otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, alarm, hava tankı, 3 ad. Vidalı kompresör (sistem eş yaşlanmalı), filtre grubu, kurutucu (Basınçlı hava kurutucuları Avrupa Farmakopya Standartlarında hava üretirken aynı zamanda Uluslararası Solunabilir Hava Standartlarına uygun olmalıdır.) ve regülatörler ile komple iş yerinde temini ve montajı.

Not: Kompresör kapasiteleri 10 bar basınca göre hesaplanmıştır. Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.