

## 25.665.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.665.1103 (695-103)</b>
<b>Tanımı</b>	Paket Tipi 3 gözlü morg ünitesi, Paket Tip Morg Ünitesi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Hastane Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	86959,40	643,75	321,88
2022-3	87152,50	836,88	418,44
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	51268,80	643,75	321,88
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	14100,00	254,00	127,00
2020	32780,00	434,00	217,00
2019	24870,00	369,00	184,50
2021	41940,00	530,00	265,00
2018	18300,00	291,00	145,50
2016	10486,25	236,25	118,13
2023-1	126545,63	1295,63	647,82
2023-2	177443,75	2093,75	1046,88

## 25.665.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

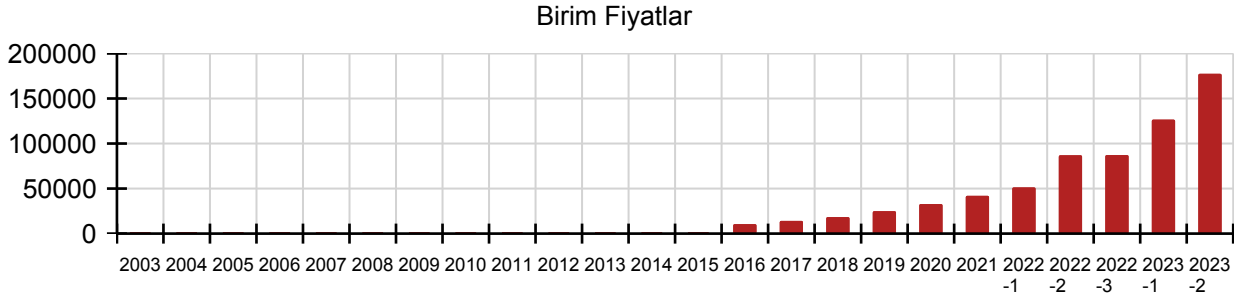

### Yapım Şartları

Paket Tip Morg Ünitesi: (Ölçü: Ad.) TS EN 60335-2-89 standardına haiz, AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan mamul paket tip Morg ünitesinin tüm panelleri 40-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta sıvı olarak enjekte edilmiş poliüretan dolgulu, izolasyonu ve sızdırmazlığı sağlanmış, dış panel izolasyon kalınlığı en az 70 mm, ara panel izolasyon kalınlığı en az 38 mm olup, paneller çıkartılabilir olmalıdır. Ünitenin taban ve tavan panelleri en az 14 noktadan kaynak veya PVC panel kilit sistemi ile birleştirilmiş, ön-arka ve orta duvar bağlantıları en az 600 mm aralıklarla sabitlenmiş, hücrelerin kendilerine ait su gider sistemleri ve hücreler arasında bulunan ara raflar çıkartılabilir ve sızdırmaz olacaktır. Hücre girişleri önden açılır olması durumunda en az 660x530 mm, yandan açılır olması durumunda en az 2015x460 mm ölçülerinde olup hücre girişi çerçevesi ile hücre kapağı kilit -menteşeleri PVC esaslı malzemeden mamul, kapak sızdırmazlığı sağlanmış, değişebilir contalı, içeriden açılabilen özellikte kapak kilidi kullanılmış, kapak menteşelerini tutan vidalar perçin somun ile sabitlenmiş, her hücrenin soğutma sistemi birbirinden bağımsız, mikro işlemci kontrollü onaylı projesinde belirtilen kapasitelerde soğutma yapabilen evaporatörlü soğutma grubuna sahip, hücrelerde ara raf üzerinde en az 5 rulodan en fazla 25 mm çapında borudan oluşan, kaynaklı gerektiğinde çıkartılabilen konveyör sistemi olup, her hücreye ait takriben en az 1900 mmx600 mm ebatlarında ve en fazla 150 kg ağırlığa dayanıklı PVC esaslı kulpları olan cenaze tavası bulunmalı, morg ünitesinin hareketi için en az 150 mm çapında ikisi frenli 4 adet tekerlek bulunan ünitenin iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.665.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.