

## 25.652.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.652.1507

**Tanımı** 4x300 m3/h (Tank =2x2000 lt), Medikal vakum merkezi

**Birimi** Tk

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Hastane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2024	1845243,05	21261,80	10630,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

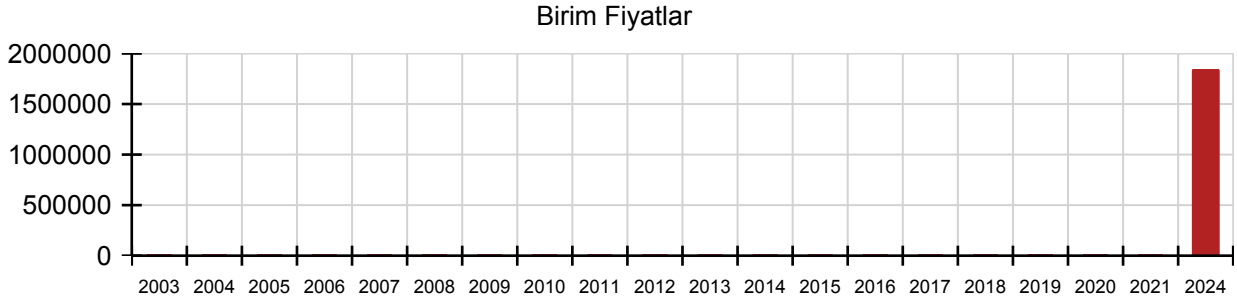

### Yapım Şartları

Medikal Vakum Merkezi (Ölçü: Tk)

Pompa grubu, otomatik kontrol paneli, vakum deposu, bakteri filtresi ve toplama kavanozu ile komple , kontrol paneli yeterli vakum seviyesini temin etmek üzere pompaları sırayla veya gerektiđi kadarını devreye alan veya devreden çıkarabilen , En az 160 m<sup>3</sup>/h debi üzerindeki pompalarda soft starter olmalı , otomatik kontrol paneli, haberleşme protokollerine uygun otomasyona ve bilgisayar sistemine bilgi aktarabilen, vakum tankı, Pompaları, biriktirme kabı ve bakteri filtresi ile komple TS EN ISO 7396-1 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, medikal vakum merkezinin iş yerinde temini ve montajı.

Not: Üç kompresörlü sistemlerde her bir kompresör dizayn kapasitesini %100 karşılamalıdır. Kompresör dışı sistem elemanları, dizayn kapasitesine göre seçilmelidir .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.652.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.