

## 43.696.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.696.1161

**Tanımı** ORP analizör setinin yerleştirilmesi (ORP analizör seti dahil)

**Birimi** AD

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

## 43.696.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

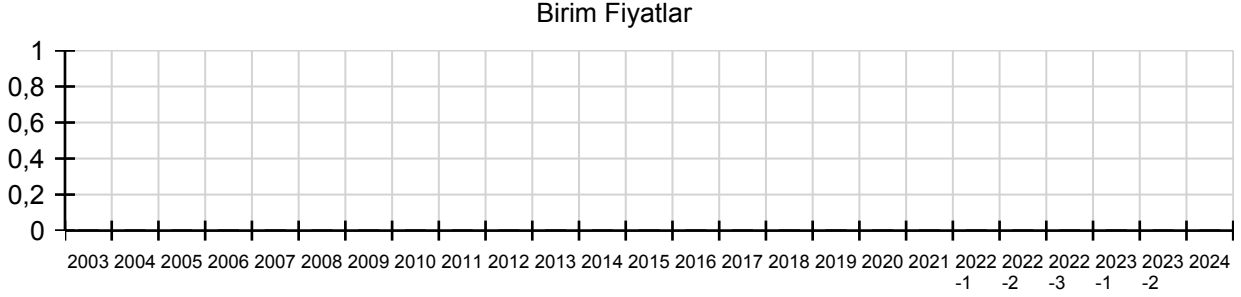

### Yapım Şartları

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, PTFE diyaframalı ya da açık diyaframalı, ölçüm elektrodu ve referans elektrodunu içinde bulunduran, sensöre ait tüm bilgiler (maksimum ORP, maksimum sıcaklık vs.) ve kalibrasyon bilgileri transmitterden okunabilen, ölçüm yüzeyi altın, cam veya platin, referans sistemi Ag/AgCl veya KNO<sub>3</sub>-KCL olan, koruma sınıfı en az IP67, azami basınç dayanımı 6 bar, ölçüm aralığı; -1200 - +1200 mV ya da bu aralığı kapsayan daha geniş bir aralıkta olan, laboratuarda kalibrasyonu mümkün, geniş ve okunaklı bir LCD göstergesi olan, göstergede ORP ve sıcaklık değerleri aynı anda izlenebilen, alarm veya hata durumlarında kullanıcıyı uyarıp hata sinyali verebilen, çalışma sıcaklığı; -20 °C - +70 °C, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları ile transmitter ünitesi, probu dahil ORP analizör setinin kalibrasyonunun yapılarak nin yerleştirilmesi 1 (bir) adet fiyatı.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, ORP analizör setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

ORP analizör setine 1 adet transmitter ve 1 adet sensör (elektrod / prob) dahildir.

Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

## 43.696.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.